



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	单通道热释电火焰探测器IF5.0B
产品型号 MODEL	MS-FLMS2-11BSP
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：[http:// www.minsisensor.com](http://www.minsisensor.com)

邮箱：[minsi@ minsensensor.com](mailto:minsi@minsensensor.com)



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属敏思传感技术有限公司(以下称本公司)所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。


感谢您使用敏思传感的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

敏思传感技术有限公司



产品说明:

MS-FLMS-11BSP火焰探测 / FRF1+FRF2 (环境参比) 单通道热释电火焰探测器基于钽酸锂(LiTaO_3)单晶热释电效应, 搭配超低噪声场效应管和高阻值门电阻系统组成探测电路; 采用 TO-5 金属管壳封装; 以精密窄带滤光片为红外光学窗口; 三个探测器组合使用可以更好消除环境(光)对火焰探测器报警的干扰, 可广泛用于火焰探测报警。

最大额定温度:


参数	典型值	单位	备注
工作温度	-20 至+60	°C	
存储温度	-40 至+85	°C	

性能参数:


参数		典型值	单位	备注
窗口尺寸		4.9*4.9	mm	
热释电芯片尺寸		1.5*1.5	mm	
温度补偿片		无		
视场角	最小值	120	°	
电压响应率	典型值	700	V/W	500K、10Hz、25°C、无窗口及滤光片
噪 声	最大值	520	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	10 Hz
探测率	典型值	3.5×10^8	$\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} \cdot \text{W}^{-1}$	500K、10Hz、25°C、无窗口及滤光片
热时间常数	典型值	200	ms	
电时间常数	典型值	1.5	s	
工作电压	典型值	2-15	V	推荐: 3.3-5V
源极电压	典型值	0.2-1.5	V	




探测器频谱特性:

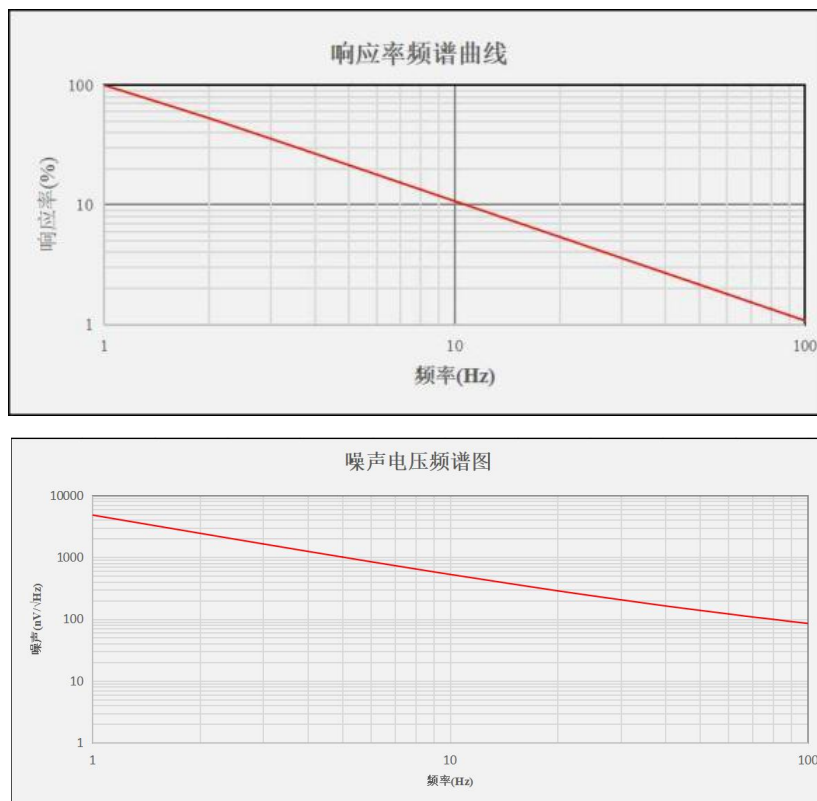


探测器封装尺寸图

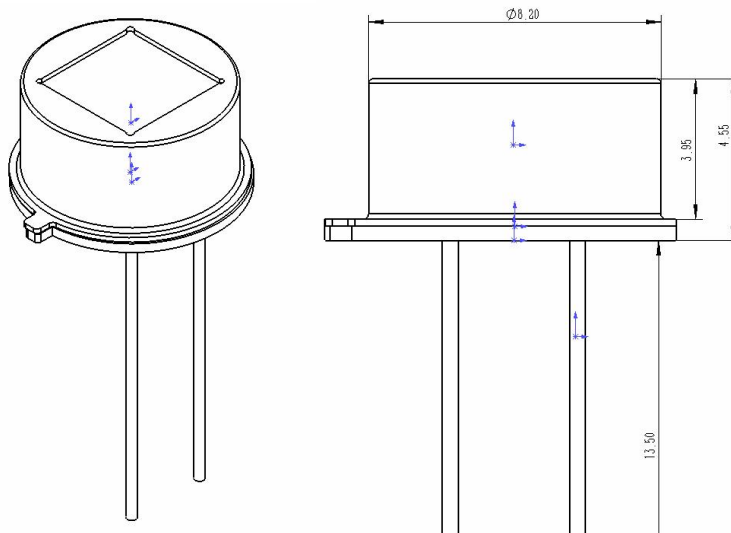

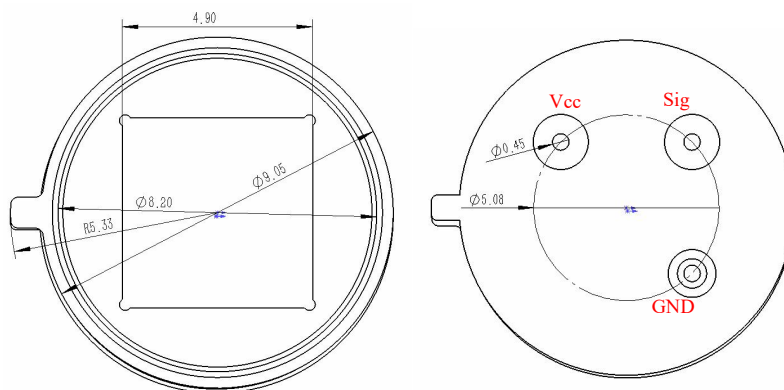

探测器内部电路及测试电路图：

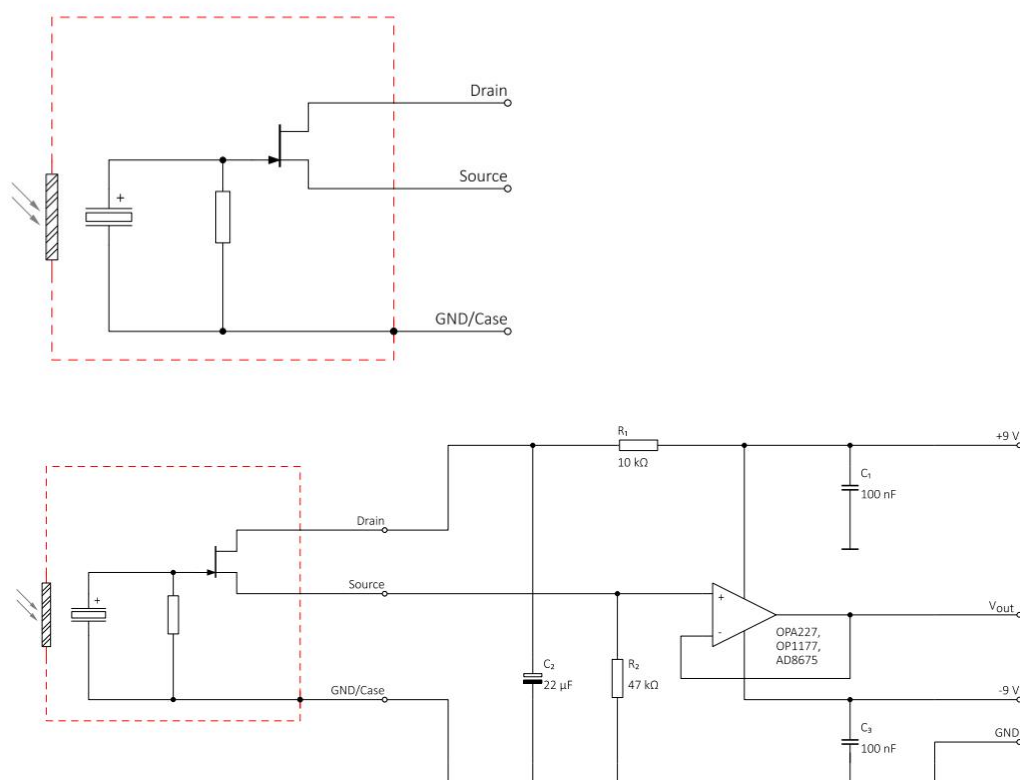

探测器滤光片参数指标：

产品型号	MS-FLMS-11BSP	MS-FLMS1-11BSP	MS-FLMS2-11BSP
滤光片参数指标	CWL:4500/FWHM:420	CWL:3800/FWHM:180	CWL:5000/FWHM:220
截止带	UV~11um		



注意事项:

(1) 热释电红外探测器是典型的热交流工作器件。当目标静止、温度不变时，热释电红外探测器没有有效信号输出。只有发生瞬态目标移动，或者温度变化，或者用斩波器进行光源调制时，才有信号输出；

(2) 在操作、使用和保存热释电红外探测器过程中，要避免快速温度变化，当温度变化速率小于 0.5°C/分钟时，探测器才能保持正常工作。如果探测器升温速度过快，有可能造成钽酸锂玻片的损坏；

(3) 热释电红外探测器具有压电性，对声音、电磁波、震动都十分敏感，使用热释电红外探测器时，适当的减震和屏蔽是必要的；

(4) 焊接热释电红外探测器时，建议在 4mm 以上位置焊接，焊接时间要尽可能短，并用镊子夹住管脚根部帮助散热，防止探测器灵敏元损伤。要防止元件跌落，且需注意静电防护，备用元件要干燥保存；

(5) 当操作热释电红外探测器时，由于手的接触，特别是经过焊接，改变了热释电红外探测器本体的温度，所以探测器重新工作时，需要等待一段时间，待探测器本体温度平衡后，才能恢复正常工作。探测器加温后，如立即接通电源，此时探测器可能处于截止状态；探测器通电后，需要等待一段时间(如 30 秒)，等待探测器稳定后，才能正常工作；

(6) 探测器操作环境应保持干净整洁，避免用手或硬物直接接触碰滤光片，保持窗口清洁；窗口有污染物时，可用无水乙醇棉球轻轻擦拭干净；

(7) 避免探测器底座根部片脚受力造成探测器气密性损伤。